Триглицериды

GPO-PAP (глицерол-3-фосфатоксидасный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Триг

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Тест	Триг	R1	200
№	*	R2	0
Полн.назв	Триглицериды	Объем проб	2
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	505	Диап.линейн.	0.01 – 11.30
Втор.крив	700	Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 – 38	Коэфф.	
Вр.инкуб.		Комп. Наклон 1	Отс. 0
Единица	mmol/L	Проверка прозоны	
Точн.	0.01	q1 q2 q3 q4	
		ПК	Пог

Доб. | Удалить | OK | Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Триг

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	2.3
2	Жен	Сыворот		0	2.3

Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок

Доб. | Удалить | OK | Отмена

Доб. | Удалить | OK | Отмена

Триглицериды

GPO-PAP (глицерол-3-фосфатоксидасный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

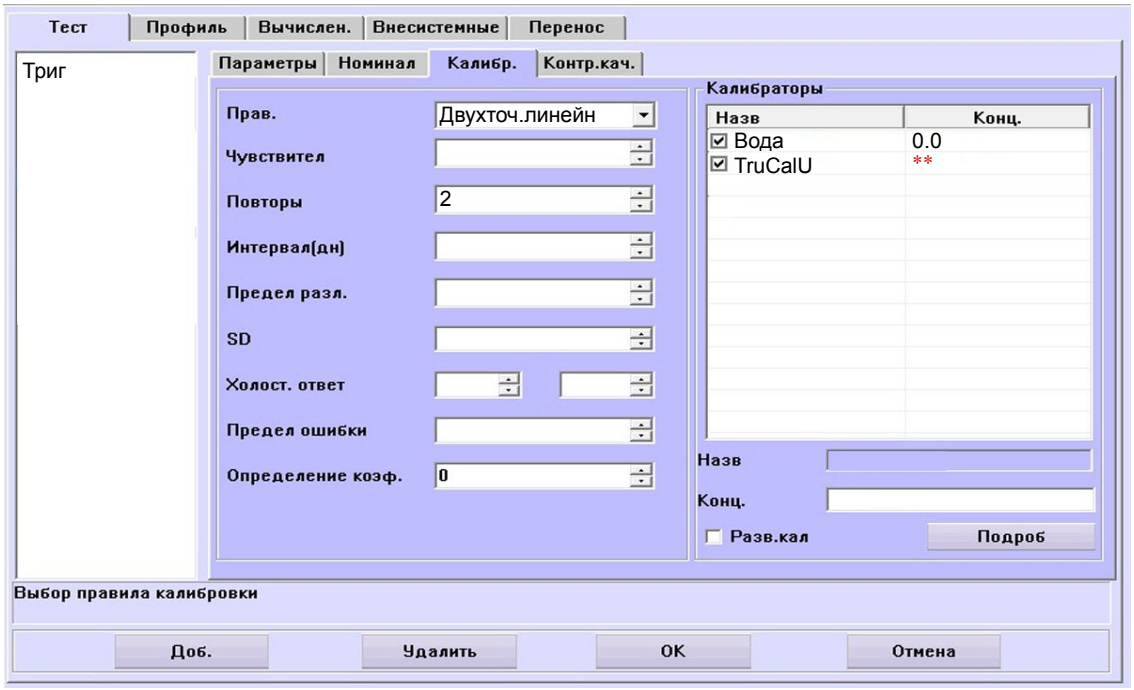

**-вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или стандарту из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.