



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

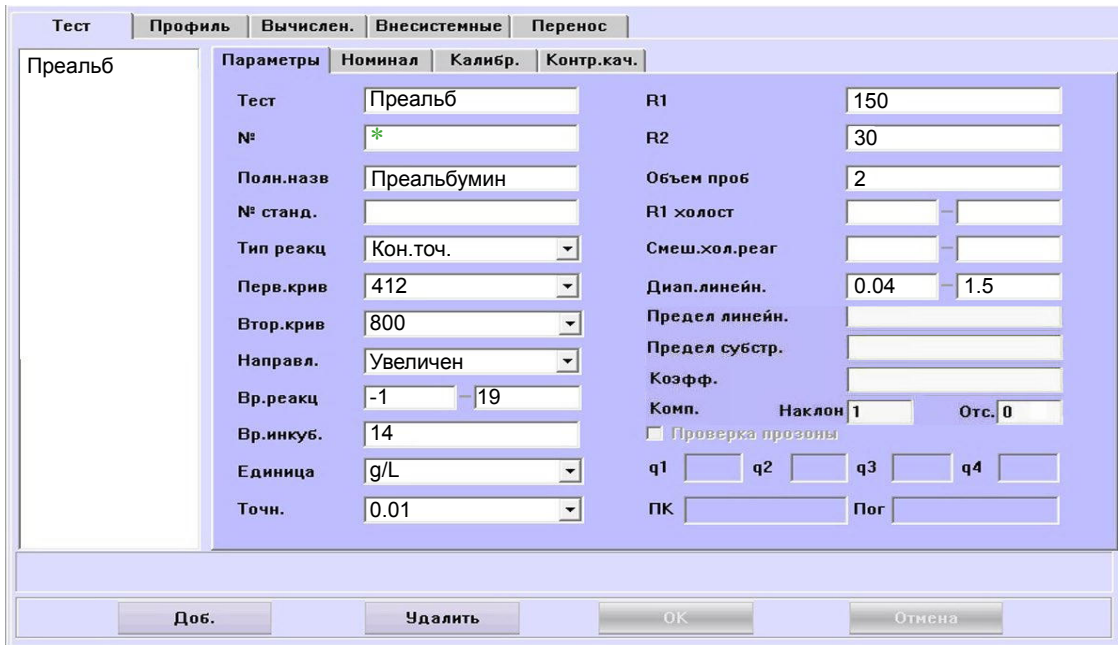

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

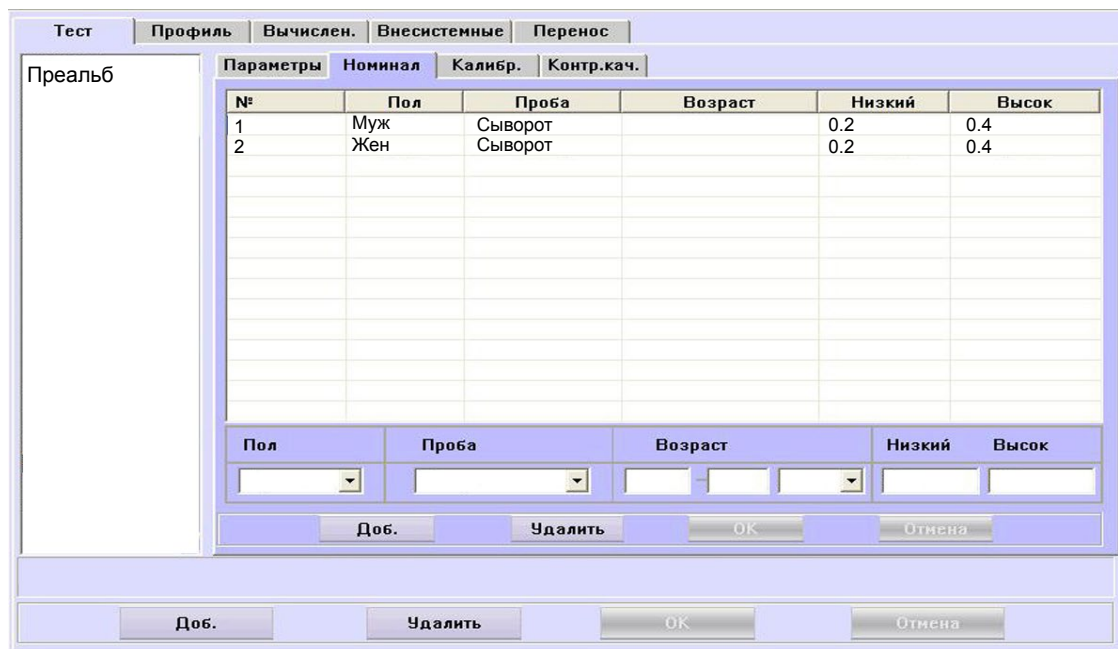

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Преальб

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruPr-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TruPr-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TruPr-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TruPr-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> TruPr-5	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit, (сплайн) 6 точек, набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (или физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.