Альбумин

BCG (метод с бромкреазоловым зеленым)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Альбум

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Тест	Альбум	R1	300
№	*	R2	0
Полн.назв	Альбумин	Объем проб	3
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	546	Диап.линейн.	2 – 60
Втор.крив		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 – 33	Коэфф.	
Вр.инкуб.		Проверка прозоны	
Единица	g/L	q1 q2 q3 q4	
Точн.	0.1	ПК Пог	

Доб. | Удалить | OK | Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Альбум

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		35	52
2	Жен	Сыворот		35	52

Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок

Доб. | Удалить | OK | Отмена

Доб. | Удалить | OK | Отмена

Тел.: (495) 980-63-39 e-mail: sale@diakonlab.ru
Факс: (495) 980-66-79 сайт: www.diakonlab.ru

Альбумин

BCG (метод с бромкреазоловым зеленым)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

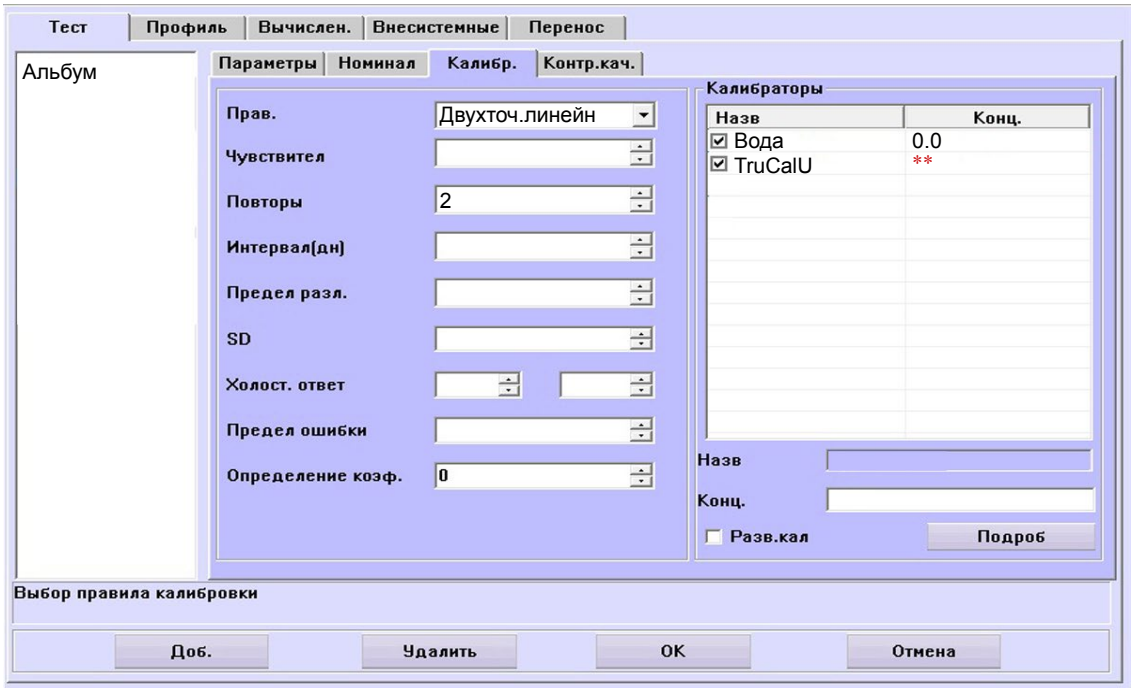

**-вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тел.: (495) 980-63-39 e-mail: sale@diakonlab.ru
Факс: (495) 980-66-79 сайт: www.diakonlab.ru