



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

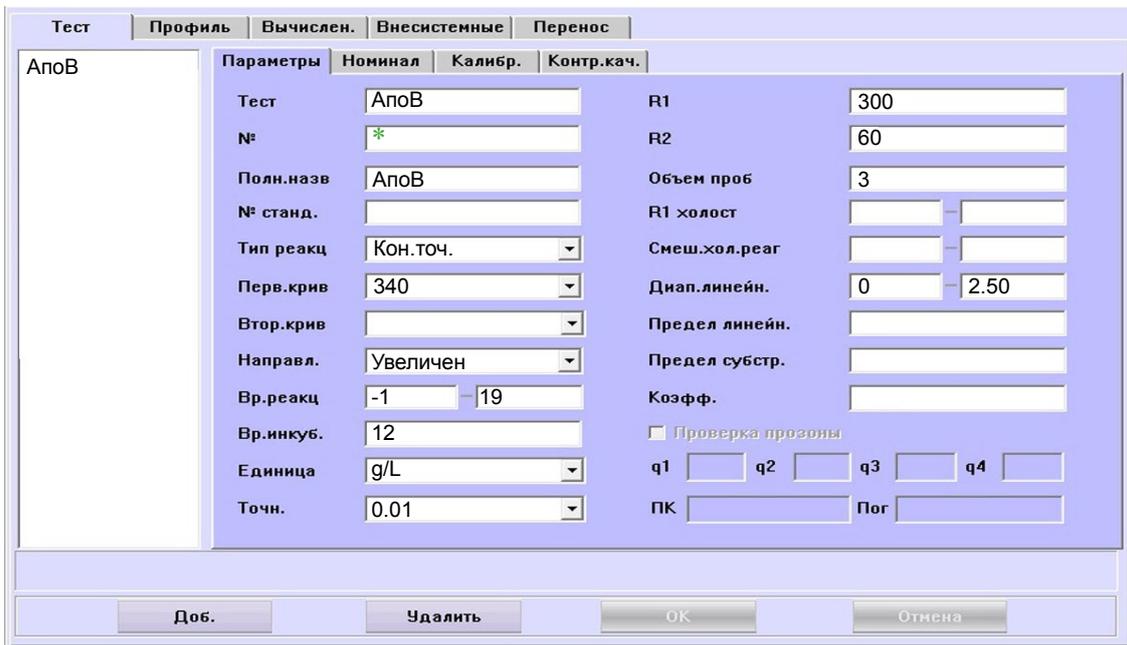

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

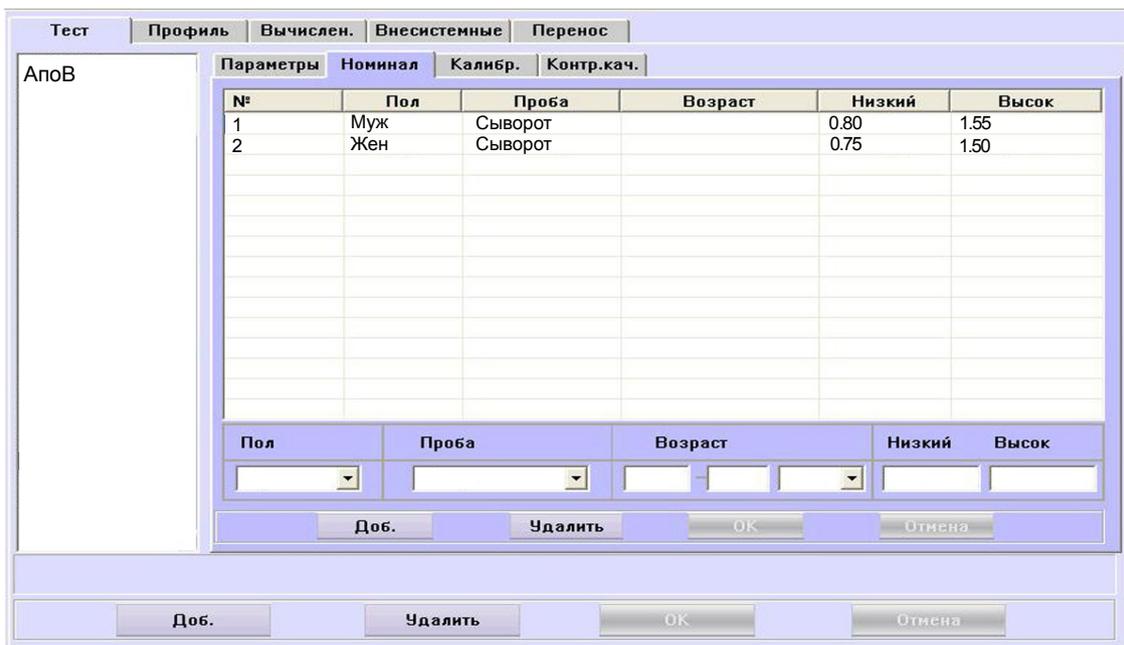

| № | Пол | Проба   | Возраст | Низкий | Высок |
|---|-----|---------|---------|--------|-------|
| 1 | Муж | Сыворот |         | 0.80   | 1.55  |
| 2 | Жен | Сыворот |         | 0.75   | 1.50  |
|   |     |         |         |        |       |
|   |     |         |         |        |       |
|   |     |         |         |        |       |
|   |     |         |         |        |       |
|   |     |         |         |        |       |
|   |     |         |         |        |       |
|   |     |         |         |        |       |
|   |     |         |         |        |       |

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

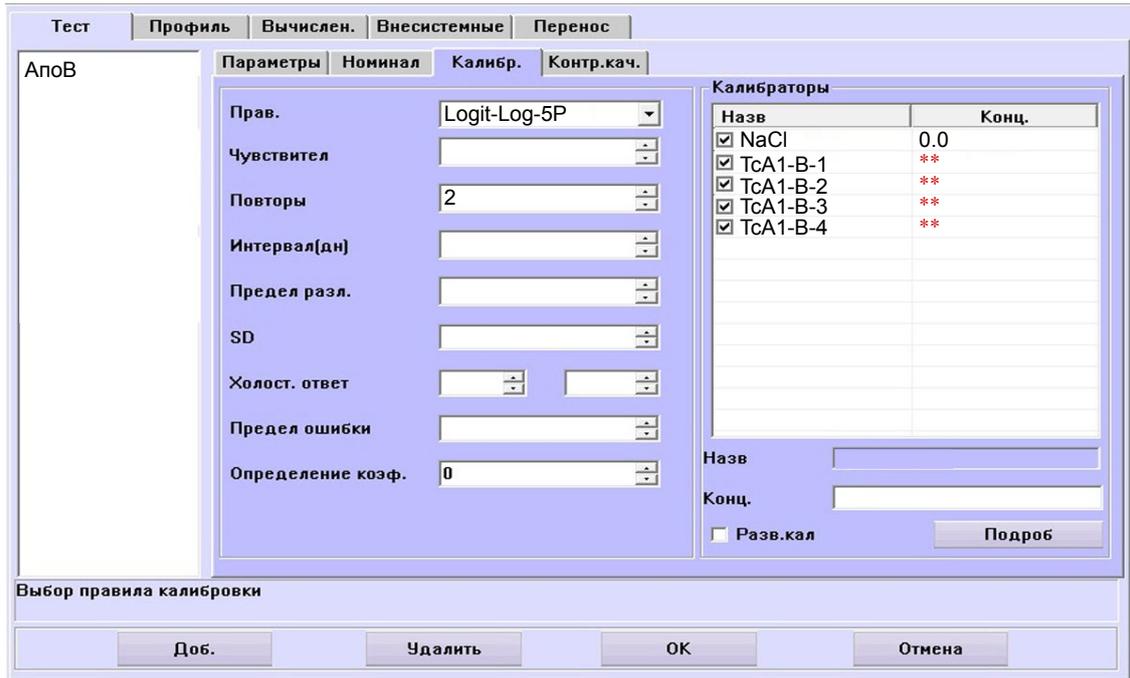

Тест    Профиль    Вычислен.    Внесистемные    Перенос

АпоВ

Параметры    Номинал    Калибр.    Контр.кач.

Прав.    Logit-Log-5P

Чувствител.    -

Повторы    2

Интервал(дн)    -

Предел разл.    -

SD    -

Холост. ответ    -    -

Предел ошибки    -

Определение коэф.    0

**Калибраторы**

| Назв.  | Конц. |
|--|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> NaCl     | 0.0   |
| <input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-1 | **    |
| <input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-2 | **    |
| <input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-3 | **    |
| <input checked="" type="checkbox"/> TcA1-B-4 | **    |

Назв.    -

Конц.    -

Разв.кал   

Выбор правила калибровки

\*\* - вводится из паспорта к калибратору.

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн, сплайн2) 6 точек

Набор стандартов TruCal Apo A1-B 5 уровней + вода (или физраствор).

Контроль по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.